
StaplaLätt og Robust

Art.-nr.: 144202, 144204, 144400

Tilsigtet anvendelse: Produktet er en fritstående toiletforhøjer, der er beregnet til at hjælpe brugeren med at rejse sig, til at tillade en højere siddehøjde eller til at blive brugt af brugere, der har svært ved at komme på toilettet. Produktet kan anvendes af brugere, som har balanceproblemer eller svært ved at rejse sig.

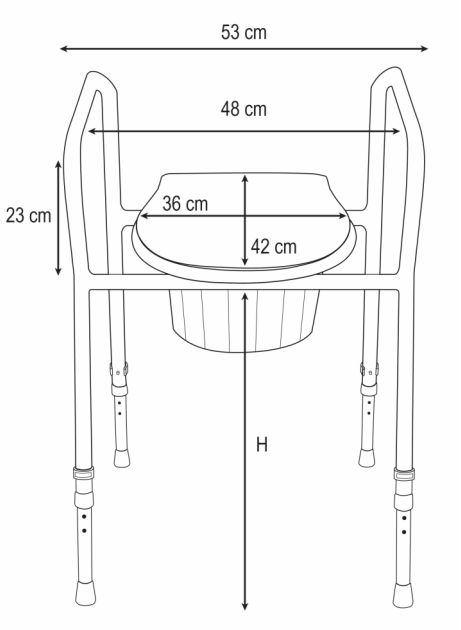


Produktvarianter

Model	Art.-nr.	Højde (H)	Vægt
StaplaLätt	144202	46-62 cm	5,4 kg
StaplaLätt mindre	144204	42-57 cm	5,2 kg
Robust	144400	45-55 cm	12,4 kg

Tilbehør

Ryglæn (Art.-nr. 144206)
Ryglæn, Robust (Art.-nr. 142143)
Blødt sæde (Art.-nr. 144210)
Støttestrop til låg (Art.-nr. 144785)
Spand (Art.-nr. 144755)
Spand med håndtag (Art.-nr. 144760)

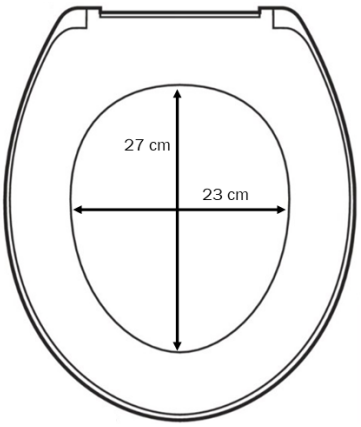

Reservedele

Støttefod, grå (Art.-nr. 120700)
Støttefod, hvid (Art.-nr. 120701)
Lågbeslag (Art.-nr. 14420208)
Toiletsæde (Art.-nr. 14420206)
Stænkskærm (Art.-nr. 144750)
Clips 25 mm (Art.-nr. 14420213)
Forlængerpose (Art.-nr. 14420225-S)
Støttefod, Robust (Art.-nr. 120702)
Sæde og låg, Robust (Art.-nr. 14440005)
Stænkskærm, Robust (Art.-nr. 144405)
Beslag til Robust (Art.-nr. 14440006)

Tekniske data

Maksimal brugervægt: 160 kg StaplaLätt/StaplaLätt mindre, 300 kg Robust
Materiale: Pulverlakeret stålramme, forlængerben i aluminium, sæde/spand/stænkskærm i PP, støttefødder i TRP-gummi, lågbeslag i POM
Forventet levetid er 5 år ved normal brug i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Levetiden kan forlænges gennem regelmæssig inspektion og vedligeholdelse udført af kvalificeret personale.
Opbevaring: stuetemperatur
Genanvendelse og affald: Yderemballagen sorteres som bølgepap, toiletforhøjerens ramme sorteres som metalskrot, plast sorteres som plast

Sikkerhedsinstruktioner

- For ordineret produkt: Risikovurdering skal udføres vedrørende brugerens behov, fysiske status og brugermiljøet, før produktet tages i brug.
- For privatpersoner: Hvis du er usikker på, hvordan produktet skal samles, eller har spørgsmål, skal du kontakte forhandleren, hvor du købte produktet, eller Swerecos kundesupport for at få hjælp.
- Når du monterer og afmonterer clipsene, skal du læse monteringsvejledningen omhyggeligt for at garantere en sikker montering.
- Der må ikke bruges værktøj ved fjernelse af clips.
- Produktet må ikke anvendes på anden måde end den tilsigtede. Personlig tilpasning af produktet er ikke tilladt.
- Toiletlåget må ikke bruges som ryglæn.
- Hvis stolen bruges fritstående, skal den placeres med ryggen mod en væg, eller der skal bruges ryglæn.
- Stolen skal placeres, så dens fire ben står stabilt på gulvet.
- Stolen skal belastes jævnt på begge sider for at minimere risikoen for, at den vælter.
- Stolen må ikke flyttes, når brugeren sidder på den. Dette kan få aluminiumsrørene til at bøje eller knække, hvilket kan forårsage personskade eller påvirke stolens stabilitet.
- Produktet må ikke bruges, hvis det har tegn på skader. Kontroller produktet regelmæssigt i henhold til vedligeholdelsesinstruktionerne.
- Slidte støttefødder kan medføre forringet greb og bør udskiftes med nye.
- Knækkede clips kan udgøre en alvorlig risiko, hvis forlængerbenet ikke sidder korrekt. Kontroller regelmæssigt, at clipsene er intakte. Hvis der opdages skader, skal clipsene altid udskiftes, før produktet må bruges igen.
- Hvis aluminiumsrøret er beskadiget, må produktet ikke bruges, da sådanne skader kan svække dets stabilitet væsentligt.
- Den justerbare fod (hvid) bør ikke skrues til endestoppet, da det vil forringe produktets stabilitet.
- Undgå at belaste forkanten af toiletforhøjerens sædering, da det kan føre til revner og beskadigelse af produktet, hvilket øger risikoen for klemskader.
- Hvis der opstår farlige situationer eller mistanke om funktionsfejl, skal dette straks anmeldes til producenten og i tilfælde af alvorlige hændelser også til den relevante myndighed i henhold til gældende regler.


Demonteringsvejledning


- Clipsene skal altid fjernes med håndkraft, og de skal trækkes lige ud, ikke lirkes af. Brug ikke værktøj såsom skruetrækkere til at lirke clipsene løs. Det kan beskadige clipsene eller andre dele af produktet.
- Forkortning af ben på Robust: Stolens ben kan forkortes af kvalificeret personale (hjælpemiddeltekniker på hjælpemiddelcentral), uden at stolens egenskaber forringes. Stolens ben kan forkortes, så højden reduceres fra 55 cm ned til 45 cm, men det skal sikres, at stolen står plant.

Monteringsvejledning


- Indstil produktet til den korrekte højde, så det passer til brugerens behov.
- Kontroller, at alle produktets dele er intakte før montering.
- Sørg for, at du bruger den rigtige clipstype.
- Clipsene skal monteres med håndkraft ved at trykke dem ind, indtil der lyder et klik, som bekræfter, at de sidder korrekt (figur 1).
- Sørg for, at clipsen er trykket helt ind, og at stiften er gået gennem begge huller i forlængerrøret og stikker ud på den modsatte side.
- Finjuster den justerbare fod, så toiletforhøjeren står plant (figur 2).
- Stolen må ikke justeres i højden, så den kun står på to ben, da den maksimale brugervægt er beregnet efter, at alle fire ben er i kontakt med gulvet.
- Monter stænkskærmen som vist på billedet (figur 3).
- Coxit-stilling er tilladt for et hældende produkt, men de forreste forlængérben må maksimalt være to huller lavere end de bagerste ben (figur 4).
- Når du monterer støttestroppen til låget, skal du føre stroppen rundt om armlænet. Træk i flappen, indtil den rager 2-3 cm ud. Kontroller, at **stroppen ikke er monteret for langt ude på armlænet.**
- Hvis stolen bruges fritstående, skal den placeres med ryggen mod en væg, eller der skal bruges ryglæn. Toiletlåget må ikke bruges som ryglæn (figur 5).
- Før brug skal du sikre dig, at toiletforhøjeren står stabilt.












SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-14 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside, under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/hjalpmedel-i- hemmet/toalettbesok/toaforhojningar

Monteringsvejledning, art.-nr. 144785 støttestrop til låg

- Monter støttestroppen til låget rundt om armlænet (figur 1)
- Træk i flappen, indtil stroppen rager 2-3 cm ud (figur 2)
- Sørg for, at støttestroppen til låget ikke er monteret for langt ude på armlænet (figur 3)

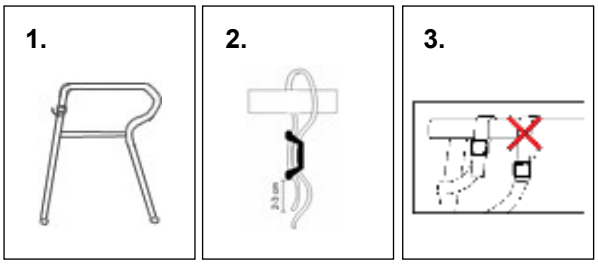

Rengøring og desinfektion

- Rengør produktet regelmæssigt med en mild sæbeopløsning (pH 5-
- 9) eller 70 % isopropanol. Brug ikke ethanol, da det kan beskadige plastdelene.
- Produkterne skal desinficeres mellem hver bruger, hvilket inkluderer en fuldstændig inspektion og udskiftning af slidte eller beskadigede dele. Desinficer efter behov produktet i dertil beregnet desinfektionsudstyr ved 85 °C i mindst 3 minutter for at sikre hygiejnisk brug.

Vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt, at toiletforhøjeren er stabil, at aluminiums- og stålrørene ikke er beskadigede, og at alle dele er intakte. Udskift slidte dele efter behov.
- Udskift clipsene med nye clips efter desinfektion af produktet.
- Når du udskifter clipsene, skal du sikre dig, at det er den rigtige model (der findes flere
- størrelser).

Genbrug

- Når produktet er udtjent, eller hvis det er beskadiget, skal det bortskaffes som metalskrot.

LOT Produktets batchnummer

REF Produktets artikelnummer

MD Produktet er et medicinsk udstyr

Produktets udløbsdato

Maksimal brugervægt

CE Produktet er CE-mærket i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745

Se brugsanvisningen

Advarsel

Producent

SRN SE-MF-000033314

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-14 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside, under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/hjalpmedel-i- hemmet/toalettbesok/toaforhojningar