Ryglæn til Toiletforhøjer StaplaLätt, Toiletforhøjer og Brusestol Robust

Art.-nr.: 144206 (StaplaLätt), 142143 (Robust)
Tilsigtet anvendelse: Ryglænet er et tilbehør til Toiletforhøjer StaplaLätt (144202, 144204), Toiletforhøjer Robust (144400) og Brusestol Robust (142140).


Robust




StaplaLätt







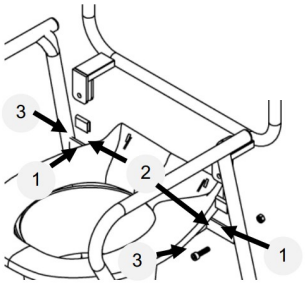

Sikkerhedsinstruktioner
Korrekt montering: Ryglænet skal monteres i henhold til anvisningerne, og du skal kontrollere, at det er sikkert fastgjort før brug. Forkert montering kan føre til ustabilitet og øget faldrisiko.

Ikke beregnet som lastbærende støtte: Ryglænet er kun beregnet som støtte, når du sidder. Du må ikke bruge det til at skubbe fra imod, når du rejser dig, eller til at læne dig kraftigt tilbage, da dette kan få stolen til at vælte.

Kontroller fastgørelse: Ryglænet skal efterses regelmæssigt for at sikre, at det ikke har løsnet sig eller har synlige skader. I tilfælde af tegn på revner eller slip skal ryglænet udskiftes.

Maks. belastning: Produktet er konstrueret til en maksimal brugervægt på 160 kg (300 kg for Robust). Overskrid ikke denne vægtgrænse, da dette kan påvirke stabilitet og holdbarhed.

Ikke beregnet til tilbagelæning: Brugeren skal sidde opret og må ikke læne sig kraftigt bagud, da det kan påvirke stolens stabilitet.

Undgå ujævne underlag: Produktet skal placeres på et stabilt, plant underlag for at minimere risikoen for, at stolen vælter ved brug af ryglænet.

Rengøring og desinfektion
- Rengør produktet regelmæssigt med en mild sæbeopløsning (pH 5-9) eller 70 % isopropanol. Brug ikke ethanol, da det kan beskadige plastdelene.
- Produkterne skal desinficeres mellem hver bruger, hvilket inkluderer en fuldstændig inspektion og udskiftning af slidte eller beskadigede dele. Desinficer efter behov produktet i dertil beregnet desinfektionsudstyr ved 85 °C i mindst 3 minutter for at sikre hygiejnisk brug.
- Hvis der opstår farlige situationer eller mistanke om funktionsfejl, skal dette straks anmeldes til producenten og i tilfælde af alvorlige hændelser også til den relevante myndighed i henhold til gældende regler.

Genvinding
- Når produktet er udtjent, eller hvis det er beskadiget, skal det bortskaffes som metalskrot.

Monteringsanvisninger (toiletforhøjer og brusestol)
1. Aftør stellet før montering.
2. Monter skridsikre stropper på stellet, hvor ryglænet skal fastgøres. På Robust ryglæn er den skridsikre strop allerede monteret.
3. Placer ryglænet på stellet over de skridsikre stropper, og fastgør ryglænet med skrue og møtrik på begge sider af stellet. Stram skruerne godt til.

Se brugsanvisningen

LOT Produktets batchnummer

REF Produktets artikelnummer

Produktets udløbsdato

Producent

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-48 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside, under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/ryggstod-till- staplalatt-144206